

5                   **Starrer Geburtensimulator mit interaktivem optischen Display**

- 10   Die Erfindung betrifft einen Geburtensimulator zum Nachbilden von vorgeburtlichen Behandlungsmethoden und zur Simulation ausgewählter Situationen beim Geburtsvorgang.

Die Ausbildung von Hebammen und Gynäkologen ist sehr aufwendig, da die  
15   Ausbildung aus verschiedenen Gründen nur sehr eingeschränkt an der Gebärenden selbst vorgenommen werden kann. Gerade in komplexen Notfallsituationen ist es nicht möglich oder ethisch vertretbar, unerfahrene Personen in die Geburtshilfe aktiv einzubeziehen. Weiterhin treten die unterschiedlichsten Problemfälle oft nicht vorhersehbar auf. So müssen Hebammen und Gynäko-  
20   logen über lange Zeiträume relativ passiv bei Geburten anwesend sein. Erst wenn die passive Ausbildung sehr weit fortgeschritten ist, kann mit der aktiven Ausbildung begonnen werden. Dabei müssen alle Handlungen von erfahrenem medizinischen Fachpersonal überwacht werden, um das Restrisiko für Mutter und Kind gering zu halten.

25

Um die gynäkologische Ausbildung zu unterstützen, werden körperliche Modelle, Filme und Computeranimationen verwendet. Es gibt zusammensetzbare hartplastische Modelle, die eine räumliche Veranschaulichung anatomischer, physiologischer oder pathologischer Zusammenhänge ermöglichen. Es sind  
30   weiterhin weichelastische Modelle bekannt, die menschliche taktile Eigenschaften möglichst gut nachbilden sollen, d. h., in einem anatomiegerechten Mutterleib ist eine deformierbare Kinderpuppe angeordnet.

Die auszubildenden Hebammen und Gynäkologen können somit diese Modelle anfassen und bestimmte Grundhandgriffe üben und sich die räumlichen Zusammenhänge, wie z. B. Kindslagen, einprägen. Vorrichtungen für diese und ähnliche Zwecke werden in den Dokumenten WO 02/01536 A1 und US 5 5,509,810 beschrieben.

Da die aus dem Stand der Technik bekannten körperlichen Modelle, Vorrichtungen, Filme oder Computeranimationen nur unzureichend für die realitätsnahe Ausbildung geeignet sind, besteht die Aufgabe der Erfindung in der Schaffung einer Vorrichtung zur Geburtensimulation, an der die Handgriffe für die Geburtshilfe gegenüber dem Stand der Technik wesentlich effektiver erlernt oder trainiert werden können.

Diese Aufgabe wird mit einem starren Geburtensimulator mit einem interaktiven optischen Display nach Anspruch 1 gelöst, wobei der Geburtensimulator nachfolgende Merkmale aufweist: Einen Mutterleibstorso, der mit einem Untergrund verbunden ist und ein Kindmodell, welches in dem Mutterleibstorso angeordnet ist, wobei vorzugsweise die natürlichen, d. h. z. B. menschliche Form- und Größenverhältnisse und Haptik eingehalten werden. Das Kindmodell ist starr mit dem Untergrund über eine Kraft-Momenten-Sensoranordnung verbunden. Diese Kraft-Momenten-Sensoranordnung ist so ausgebildet, das Kräfte und Momente, die eine untersuchende Person mit den Händen oder mit medizinischen Instrumenten auf das Kindmodell aufbringt, erfaßt und als Meßsignale bereitgestellt werden. Die Kräfte und Momente können entweder direkt auf das Kind oder indirekt über die flexible Baudecke des Mutterleibstorsos aufgebracht werden. Weiterhin ist ein Bildschirm (Display) und eine programmierbare, einen Rechner aufweisende Auswertevorrichtung vorgesehen, die mit der Kraft-Momenten-Sensoranordnung und dem Bildschirm signaltechnisch verbunden ist. In dem Rechner ist ein Simulationsprogramm mit Kraft- und Bewegungsfeedback implementiert, d. h. abgelegt. Dieses Simulationsprogramm ist so ausgebildet, daß die Meßsignale in solche Bildsignale umwandelt werden, die das natürliche Bewegungsverhalten eines Kindes im Mutterleib als adäquate Reaktionsbewegungen der Wirkung der aufgebrachten

Kräfte und Momente in Echtzeit darstellen. Somit werden auf dem Bildschirm Bilder erzeugt die zeigen, wie sich ein natürliches Kind in einem natürlichen Mutterleib verhalten würde, wenn auf Mutter und Kind die gleichen Kräfte und Momente aufgebracht werden, die auch auf den Geburtssimulator gemäß der  
5 vorliegenden Erfindung aufgebracht werden, d. h. wenn z. B. auf den Mutterleibsbauch gedrückt wird, oder wenn der Modell-Kindskopf mit einer Zange erfaßt und gezogen wird.

Der Vorteil der Erfindung besteht also darin, daß mit der Erfindung eine Mög-  
10 lichkeit geschaffen wurde, unterschiedliche medizinische Situationen vor und während der Geburt an einem körperlichen Modell zu simulieren und bildhaft genau darzustellen. Das Kind-Modell kann z. B. nur mit den Händen angefaßt werden, es ist aber ebenfalls möglich, den richtigen Einsatz von Instrumenten zu üben, wie z. B. die Verwendung einer Zange oder einer Saugglocke. Die  
15 Auswirkungen der Bedienerkräfte auf die Kindsbewegung und Physiologie von Mutter und Kind werden unmittelbar und interaktiv dem Bediener auf dem Bildschirm abgebildet. Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, daß durch eine Programmänderung, d. h. „per Knopfdruck“, eine andere medizinische Situation eingestellt werden kann.

20

Es sei angemerkt, daß das Kindmodell mechanisch starr befestigt ist und die Bewegungen des Kindes nur als Visualisierung auf dem Bildschirm abgebildet werden. Da der mechanische Aufbau des Geburtensimulators einfach und sehr robust ist, wurde somit ein didaktisch anspruchsvoller, aber kostengün-  
25 stiger Geburtensimulator geschaffen.

Nach Anspruch 2 ist das Kindmodell lösbar an der Kraft-Momenten-Sensoranordnung befestigt und der Mutterleibstorso weist eine Klappe auf. So ist es z. B. möglich, unterschiedlich Kindmodelle zu verwenden und diese  
30 leicht auszutauschen.

Nach Anspruch 3 kann das Kindmodell in verschiedenen Positionen an der Kraft-Momenten-Sensoranordnung befestigt werden. Dadurch sind spezielle Kindslagen simulierbar.

- 5 Nach Anspruch 4 ist wenigstens ein, mit der Auswertevorrichtung signaltechnisch verbundener Schallerzeuger vorgesehen, so daß die bei der realen Untersuchung oder bei der natürlichen Geburt durch Mutter oder Kind oder durch medizinische Geräte auftretenden typischen Geräuschen eingespielt werden können. Die Geräusche können synthetisch erzeugt oder auch natürlichen Ursprungs sein, d.h. es handelt sich um Tonbandaufnahmen, die während einer
- 10 adäquaten natürlichen Situation aufgenommen wurden. Durch diese Maßnahme wird für die auszubildende Person ein sehr wirklichkeitsnaher Eindruck erzeugt, wenn z.B. bei einer heftigen Wehentätigkeit zeitgleich ein Stöhnen der Gebärenden eingespielt wird.

15

Nach Anspruch 5 ist der Schallerzeuger im Mutterleibstorso und/oder im Kindmodell integriert, so daß z. B. Geräusche aus dem Mutterleib realitätsnah erzeugt werden können. Damit können insbesondere die durch das Kind verursachten Geräusche sehr echt simuliert werden.

20

- Nach Anspruch 6 ist in dem Rechner ein Signal- und Hinweisprogramm implementiert, welches Bedienungshinweise, simulierte physiologische Werte, Geräteoutputs und Warnhinweise auf dem Bildschirm zur Anzeige bringt, wie z. B. Hinweise über gefährliche Situationen, Zeitverläufe der berechneten physiologischen Größen von Mutter und Kind oder auch Bedienungshinweise.
- 25 Dem Fachmann ist klar, wie dieses Programm auch mit dem Simulationsprogramm zusammenarbeiten kann.

- Mit Anspruch 7 wird ein Kindmodell für den Geburtensimulator nach den Ansprüchen 1 bis 6 als eine eigenständige Erfindung beansprucht.
- 30

An dem Kindmodell sind im Halsbereich und/oder im Bereich des Schädeldachs, das aus verformbaren Segmenten besteht, Kraft- und/oder Drucksensoren angeordnet, die signaltechnisch mit der Auswertevorrichtung verbunden

- sind. Dieses mit Sensoren versehene Kindmodell ermöglicht die Gewinnung zusätzlicher und genauerer Informationen über den Krafteinsatz und über Palpationsvorgänge, so daß damit mehr und genauere Kraft- und/oder Momenteninformationen zur Berechnung der Reaktionskräfte und der dazugehörigen
- 5 Reaktionsbewegungen zur Verfügung stehen.

Es sei weiterhin erwähnt, daß bei Bedarf der Fachmann auch weitere Sensoren an geeigneten Stellen am Kind oder auch am Mutterleibstorso anordnen wird, wenn es zur Signalgewinnung bei der Umsetzung einer konkreten Bewegungssimulation erforderlich ist. So können z. B. zusätzlich auf dem

10 Bauchbereich des Mutterleibstors Drucksensoren angeordnet werden. Die Meßsignale dieser zusätzlichen Sensoren werden dem Simulationsprogramm und/oder dem Signal- und Hinweisprogramm zugeführt.

- 15 Die Kraft-Momenten-Verläufe können z. B. auch aufgezeichnet werden, während eine ausgebildete Person am Geburtensimulator eine Geburt simuliert. Ebenso wird bei einer auszubildenden Person verfahren. Anschließend werden die beiden Kraftverläufe verglichen. Diese Methode hat einen hohen didaktischen Wert.

20

Es ist klar, daß die Erfindung vorwiegend für menschliche Anwendungen geeignet ist. Die Erfindung kann aber prinzipiell auch in der Veterinärmedizin angewendet werden.

- 25 Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit schematischen Zeichnungen näher erläutert.

- Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung der Erfindung mit ihren einzelnen Komponenten.
- 30 Fig. 2 zeigt zwei geöffnete Bauchtorso.
- Fig. 3 zeigt 4 Bauchtorso mit unterschiedlichen Kindsmodellen.
- Fig. 4 zeigt ein Kindmodell mit Sensoren.

Die Fig. 1 zeigt schematisch den Querschnitt eines Geburtensimulators in Form eines Bauchtorsos 1 einer Schwangeren mit einem Kindmodell 2. Der Bauchtorso 1 ist auf einer Unterlage 3, z. B. auf einem Tisch, fest angeordnet. Das Kindmodell 2 ist in einer Höhlung 4 angeordnet, welche die Gebärmutter 5 simuliert. Der Bauchtorso 1 und das Kindmodell 2 sind aus einem weichelastischen Kunststoff ausgebildet. Das Kindmodell 2 ist über einen Sechskomponenten-Kraft-Momenten-Sensor 6 mit der Unterlage 3 verbunden.

Eine auszubildende Person 5 kann das Kindmodell 2 wie bei einer realen Geburt berühren und Kräfte einleiten. Die dabei auftretenden Kräfte und Momente werden von dem Sechskomponenten-Kraft-Momenten-Sensor 6 erfaßt, in elektrische Signale umgewandelt und der Simulations- und Auswertevorrichtung zugeführt. Die Meßdaten können gespeichert werden. Dies ermöglicht einen Vergleich dieser Meßdaten mit gespeicherten Soll-Kraftverläufen eines erfahrenen Geburtshelfers. Aus den Abweichungen zwischen den verfolgten Kraftverläufen und den gespeicherten Soll-Kraftverläufen können Rückschlüsse auf den Trainingserfolg der auszubildenden Person gezogen werden.

Wenn eine Person 5 das Kindmodell 2 mit den Händen indirekt über die elastische Bauchdecke des Bauchtorsos 1 oder auch direkt mit der Hand oder mit einem medizinischen Instrument berührt, werden von dem Sechskomponenten-Kraft-Momenten-Sensor Meßsignale erzeugt, aus denen die theoretisch resultierenden Bewegungen berechnet werden. Das in der Simulations- und Auswertevorrichtung rechnerisch simulierte Kind führt eine Bewegung aus, welches einer realen Reaktionsbewegung eines natürlichen Kindes entspricht.

Das Simulationsprogramm für die Geburtssimulationsberechnung beinhaltet somit ein Computermode'll, welches die biomechanischen Beziehungen zwischen Becken, Gebärmutter, Bändern, Sehnen, Haut und Muskulatur der Mutter und dem Körper des Kindmodells enthält. Es beschreibt die statischen und dynamischen Zusammenhänge zwischen den auftretenden Kräften und Momenten, die eine Person, wie z. B. die auszubildende Hebamme, auf das Kindmodell aufbringt, und die Lagen und Bewegungen, die das Kind relativ

zum Körper der Mutter einnimmt. Dadurch können aus den gemessenen Kräften und Momenten die resultierenden Bewegungen des Kindmodells 2 berechnet werden.

- 5 Weiterhin werden aus den in dem Simulationsprogramm aufbereiteten Bewegungsinformationen in einer Bewegungsanimationsrechnung die Bewegungen und Verformungen der anatomischen Komponenten, wie z. B. Becken, Gebärmutter, Bänder, Sehnen, Haut, Muskulatur der Mutter und des Kindes, ermittelt und in Echtzeit auf einem Monitor 7 visualisiert. Es können unterschiedliche Darstellungsarten gewählt werden, wie z. B. eine röntgenbildähnliche Darstellung oder eine ultraschallbildartige Darstellung, wobei z. B. besonders gefährdete Abschnitte oder Verletzungen farbig hervorgehoben werden können. Gleichfalls ist es möglich, zwischen verschiedenen Darstellungsarten umzuschalten. Da die visuellen Informationen zeitgleich mit den haptischen
- 10 Informationen der agierenden Person 5 übermittelt werden, entsteht für die Person 5 ein sehr realistischer visueller Gesamteindruck.
- 15

- Weiterhin können zusätzlich aus den biomechanischen Gelenkberechnungen auch noch Schmerzgrenzwerte ermittelt werden, die bei Überschreitung einen
- 20 Befehl zum Abspielen eines Soundsamples auslösen. Diese Soundsamples sind in einem Speicher abgelegt und werden nach Anforderung aufgerufen und über ein Stereolautsprechersystem 8 wiedergegeben. Es ist für die agierende Person 5 von nachhaltiger lernpsychologischer Wirkung, wenn z. B. bei einem falschen Handgriff ein Schmerzenslaut ertönt, die Herztöne des Kindes
- 25 oder der Mutter hörbar sind, oder wenn das Kindmodell nach erfolgreicher Geburt wie ein natürliches Kind schreit.

- Durch die graphische, bildhafte Darstellung der resultierenden Kindsbewegung hat die agierende Person 5 den subjektiven Eindruck einer realen Reaktion.
- 30 Durch entsprechende Parameterwahl in der Geburtssimulationsberechnung lassen sich nicht nur normale Geburtsvorgänge oder Kindsbewegungen simulieren, sondern auch seltene Situationen und Problemfälle darstellen und anschaulich vermitteln.

Die Fig. 2 zeigt zwei Bauchtorsos mit einer Klappe, die in Pfeilrichtung um ein Gelenk schwenkbar ist. Es ist gezeigt, daß in der Fig. 2 das größere Kind gegen ein kleineres Kind ausgetauscht wurde.

- 5 Die Fig. 3 zeigt vier Bauchtorsos, in denen Kindsmodele unterschiedlicher Größe und in unterschiedlichen Lagen angeordnet sind.

Die Fig. 4 zeigt ein Kindmodell 2, dessen Kopf über einen Kraft- und Drehmomentensensor 9 mit dem Rumpf verbunden ist. Bei der Geburtensimulation ist  
10 es besonders wichtig, Handgriffe am Kopf des Kindmodells 2 zu üben. Dabei wird der Hals des Kindes besonders beansprucht. Die Schädeldecke des Kindes ist mit weiteren Kraftmeßsensoren 10 ausgestattet, um auch im Bereich der Schädeldecke räumlich selektive Krafteinleitungen, z.B. während des Palpierens, eindeutig erfassen zu können. Es ist daher bei der Überwachung einer  
15 simulierten Geburt von besonderer Bedeutung, die Kopfgriffe zu kontrollieren, was mit dieser Ausführungsform eines Kindmodells besonders genau möglich ist. Für die Übertragung der elektrischen Meßsignale zur Auswertevorrichtung stehen dem Fachmann drahtgebundene sowie drahtlose Übertragungsverfahren zur Verfügung.

20

Nachfolgend werden weitergehende Hinweise zur Realisierung des biomechanischen Modells gegeben.

Zur Umsetzung der Erfindung wird das zu Grunde liegende biomechanische Modell entwickelt. Im biomechanischen Modell wird der Zusammenhang zwischen den von außen (Bediener) auf das Kind eingeprägten Lasten, d.h. Kräfte  
25 und Momente (Ursache) und der zugrundeliegenden Bewegung oder Position (Wirkung) dargestellt.

Dem Fachmann ist bekannt, daß das biomechanische Modell nicht alle anatomischen Komponenten und Formen explizit beinhalten muß. Es reicht eine  
30 gewisse „abstrahierte“ Darstellung der mathematischen Zusammenhänge zwischen eingeprägten Kräften und resultierenden Bewegungen. D.h. eine mathematische Funktion beschreibt, welche Position, Orientierung und Ge-



schwindigkeit sich ergibt, wenn eine Kraft und ein Moment an einer bestimmten Stelle am Kind in eine bestimmte Richtung wirkt, wobei die eingeleiteten Kräfte und Momente in 3D-Richtungen (dreidimensionaler Richtung) wirken und an beliebiger Stelle der Oberfläche des Kindes angreifen können. Die resultierenden Positionen, Orientierungen und Geschwindigkeiten sind ebenso in 3D anzugeben. Die Beziehung zwischen Kraft/Moment und Lage/Bewegung hängt zudem noch von der aktuellen Position des Kindes in der Gebärmutter bzw. im Geburtskanal ab. Diese mathematischen Beziehungen können auf der Basis linearer oder nicht-linearer algebraischer Gleichungen einfach beschrieben werden. Dann ist eine Parametrisierung durchzuführen. Die Wahl der Parameter bestimmt, wie realitätsnah der normale oder pathologische Geburtsvorgang simuliert werden kann. Die Parameter können auf der Basis theoretischer Überlegungen abgeschätzt oder experimentell/meßtechnisch gewonnen werden.

Nachfolgend werden Hinweise zur Realisierung des grafischen Displays gegeben:

Auf dem Monitor werden interne anatomische Komponenten, wie Beckenknochen, Gebärmutter, Plazenta, Muttermund, Blutgefäße sowie das Kind visualisiert. Optional kann der Monitor zusammen mit einer Schutterbrille auch im Stereomodus betrieben werden, oder es kann ein Stereodatenhelm verwendet werden. Die Bewegungsanimation erfolgt synchron mit der Einleitung der Kräfte auf den Bauchtorso oder auf das Kindmodell. Die Visualisierung erfolgt auf der Basis segmentierter und 3D-rekonstruierter CT-, MRT- und Ultraschallaufnahmen. Die rekonstruierte anatomische Darstellung stellt eine Zusatzinformation dar, die bei der medizinischen Ausbildung einen hohen didaktischen Stellenwert hat. Eine derartige rekonstruierte anatomische Darstellung kann bei einer realen Geburt nicht zur Verfügung gestellt werden. In der klinischen Routine werden allerhöchstens Ultraschalltechniken zur Beobachtung und Beurteilung der Geburt verwendet. Solche Ultraschallaufnahmen können in der Bewegungsanimation auf der Basis von zusammengesetzten Einzelbildern, die synchron mit der Geburt ablaufen, simuliert werden.

In der grafischen Animation werden bewegungssynchrone Lageänderungen der Körpersegmente, Verlaufsänderungen von Blutgefäßen oder der Nabelschnur, sowie Verformungen von Muskeln, Gebärmutter, Plazenta usw. berücksichtigt. Eine Visualisierung solcher Bewegungsvorgänge ist durch so genannte „kinematische CT und MRT Aufnahmen“ dem Fachmann bekannt. Hierbei handelt es sich aber nur um eine cinematografische Technik, die keine interaktive Bedienung in mehr als einem Freiheitsgrad zuläßt und daher für eine Anwendung im VR-Bereich (virtuelle Realität) nur begrenzt geeignet ist. Eine Alternative stellt eine modellbasierte Animation dar. Dabei werden alle Komponenten in ihren relevanten geometrischen und viskoelastischen Eigenschaften und in ihrem mechanischen Zusammenwirken modelliert. Für eine realitätsnahe Simulation sind aber FE-Rechnungen (finite Elemente) und komplexe Mehrkörper-Kontaktmodelle notwendig, die den simulationstechnischen Aufwand stark vergrößern und so die Echtzeitfähigkeit gefährden könnten.

Empfohlen wird daher ein kombiniertes Verfahren, bei dem Bilddaten ebenso wie anatomische Modellbetrachtungen zum Einsatz kommen. Der Ansatz besteht darin, Geometriedaten, die aus zahlreichen diskreten Geburtsmomenten rekonstruiert werden, so zu inter- und extrapolieren, daß jede beliebige Kindposition in jedem wichtigen Freiheitsgrad dargestellt werden kann. Die Inter- und Extrapolationen können dabei modellunterstützt erfolgen, indem beispielsweise die Volumenerhaltung oder Längenkonstanz bestimmter Körperabschnitte berücksichtigt werden. Da dies mit verhältnismäßig geringem Rechenaufwand möglich ist, können echtzeitfähige und glatte Bewegungsabläufe in jeder beliebigen Richtung erzielt werden.

Verstärkt wird der Lernerfolg auch dadurch, daß die in der Simulation berechneten physiologischen Parameter von Mutter und Kind (z.B. Wehentätigkeit und Blutdruck der Mutter, Puls des Kindes) als Zeitverläufe angezeigt werden.

Nachfolgend werden Hinweise zur Realisierung des akustischen Displays gegeben:

Bei der Geburt treten eine Reihe verschiedener akustischer Signale auf, die von Lautsprechern erzeugt werden. Dazu zählen z. B. Schmerzschnreie der Mutter und Geräusche beim Austritt des Kindes. Weiterhin akustisch dargestellte Signale, wie z.B. die Wehentätigkeit der Mutter und das EKG des Kindes. Die Lautsprecher können in der Nähe der künstlichen Körperabschnitte angeordnet oder in die Körperabschnitte so eingebaut werden, daß sie von außen nicht sichtbar sind.

Die Geburtsgeräusche können an mehreren Probandinnen während der Geburt aufgenommen werden. Zur Darstellung der Geräusche werden Modelle verwendet, die die Art des Geräusches mit der zugrundeliegenden Situation und der ausgeführten Bewegungsaktionen des Bedieners in Zusammenhang bringen. Auf der Basis der Erfahrung zahlreicher Gynäkologen können diese Zusammenhänge zunächst mit Hilfe von linguistischen Variablen qualitativ beschrieben werden. Mit der Methode der Fuzzy-Logik können dann aus den linguistischen Angaben quantitative Zusammenhänge hergeleitet werden.

20

25

30

5

**Ansprüche**

- 10 1. Geburtensimulator mit interaktivem optischen Display, wobei der Geburten-  
simulator nachfolgende Merkmale aufweist:
- einen Mutterleibstorso (1), der mit einem Untergrund (3) verbunden ist,
  - ein Kindmodell (2), das in dem Mutterleibstorso (1) angeordnet ist, wobei  
vorzugsweise die natürlichen Form- und Größenverhältnisse und Haptik ein-  
15 gehalten werden,
  - eine Kraft-Momenten-Sensoranordnung (6), die das Kindmodell (2) starr mit  
dem Untergrund (3) verbindet, wobei diese Kraft-Momenten-Sensoranordnung  
(6) so ausgebildet ist, um Kräfte und Momente, die eine untersuchende Per-  
son (5) mit den Händen oder mit medizinischen Instrumenten auf das Kindmo-  
20 dell (2) aufbringt, zu detektieren und als Meßsignale bereitzustellen, wobei die  
Kräfte und Momente entweder direkt auf das Kind oder indirekt über die flexi-  
ble Bauchdecke des Mutterleibstorsos (1) aufgebracht werden,
  - einen Bildschirm (7) und
  - eine programmierbare, einen Rechner aufweisende Auswertevorrichtung, die  
25 mit der Kraft-Momenten-Sensoranordnung (6) und dem Bildschirm (7) signal-  
technisch verbunden ist, wobei
- ein in dem Rechner implementiertes Simulationsprogramm so ausgebildet ist,  
daß die Meßsignale in solche Bildsignale umwandelt werden, die das natürli-  
che Bewegungsverhalten eines Kindes im Mutterleib als adäquate Reaktions-  
30 bewegungen der Wirkung der aufgebrachten Kräfte und Momente in Echtzeit  
oder in Zeitlupe- oder in Zeitrafferdarstellung so abbilden, wie sich ein natürli-  
ches Kind im Mutterleib bei einer bestimmten Untersuchung oder während  
eines bestimmten Geburtsabschnitts verhalten würde.

2. Geburtensimulator nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Kindmodell lösbar an der Kraft-Momenten-Sensoranordnung **(6)** befestigt ist und der Mutterleibstorso **(1)** eine Klappe aufweist.
- 5 3. Geburtensimulator nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Kindmodell in verschiedenen Positionen an der Kraft-Momenten-Sensoranordnung **(6)** befestigbar ist.
- 10 4. Geburtensimulator nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** wenigstens ein, mit der Auswertevorrichtung signaltechnisch verbundener Schallerzeuger **(8)** zur Erzeugung von typischen Geräuschen vorgesehen ist, die bei der realen Untersuchung oder bei der natürlichen Geburt durch Mutter, Kind oder durch medizinische Geräte auftreten.
- 15 5. Geburtensimulator nach den Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Schallerzeuger **(8)** im Mutterleibstorso **(1)** oder im Kindmodell **(2)** integriert ist.
- 20 6. Geburtensimulator nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** das in dem Rechner ein Signal- und Hinweisprogramm implementiert ist, welches Bedienungshinweise, simulierte physiologische Werte, Geräteoutputs und Warnhinweise auf dem Bildschirm zur Anzeige bringt.
- 25 7. Kindmodell für einen Geburtensimulator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** an dem Kindmodell **(2)** im Halsbereich und/oder im Bereich des Schädeldaches, das aus verformbaren Segmenten besteht, Kraft- und/oder Drucksensoren **(9, 10)** angeordnet sind, die signaltechnisch mit der Auswertevorrichtung verbunden sind.

1/4

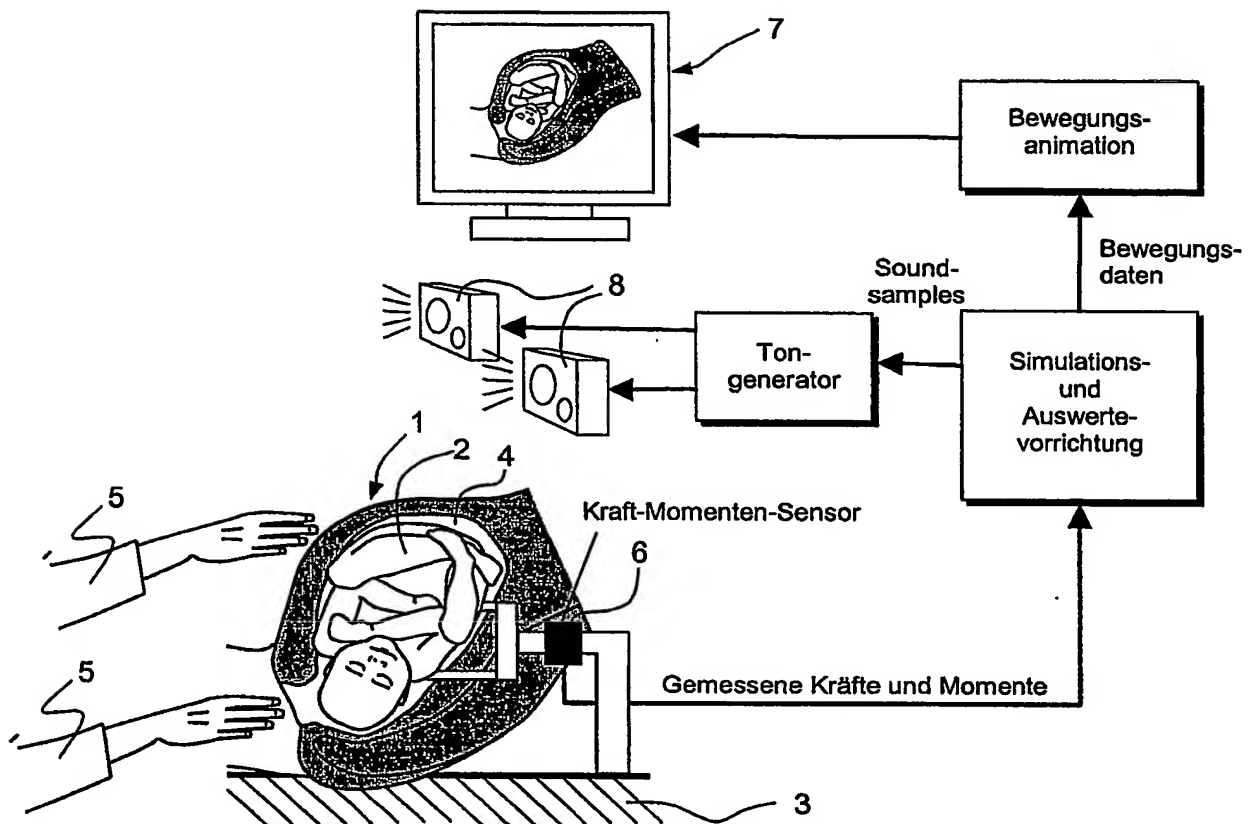


Fig. 1

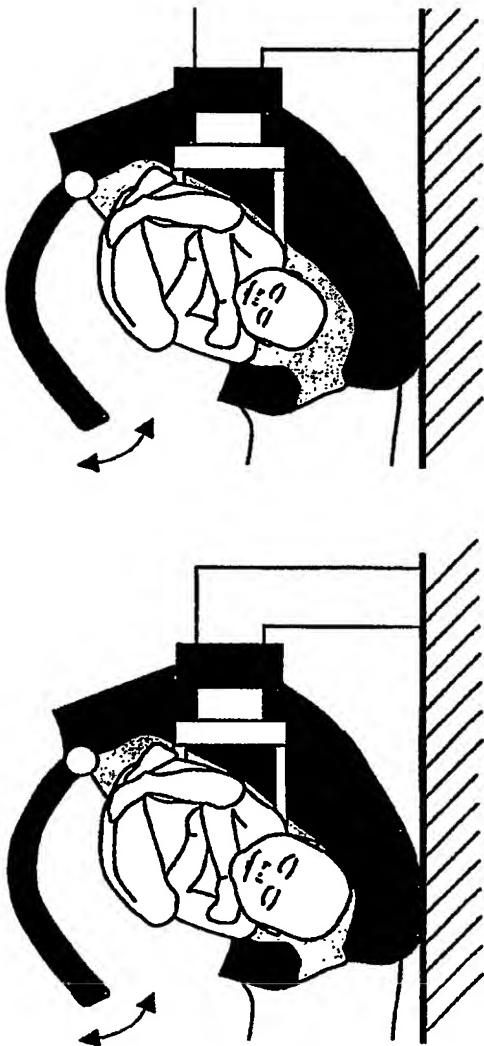


Fig. 2

3/4

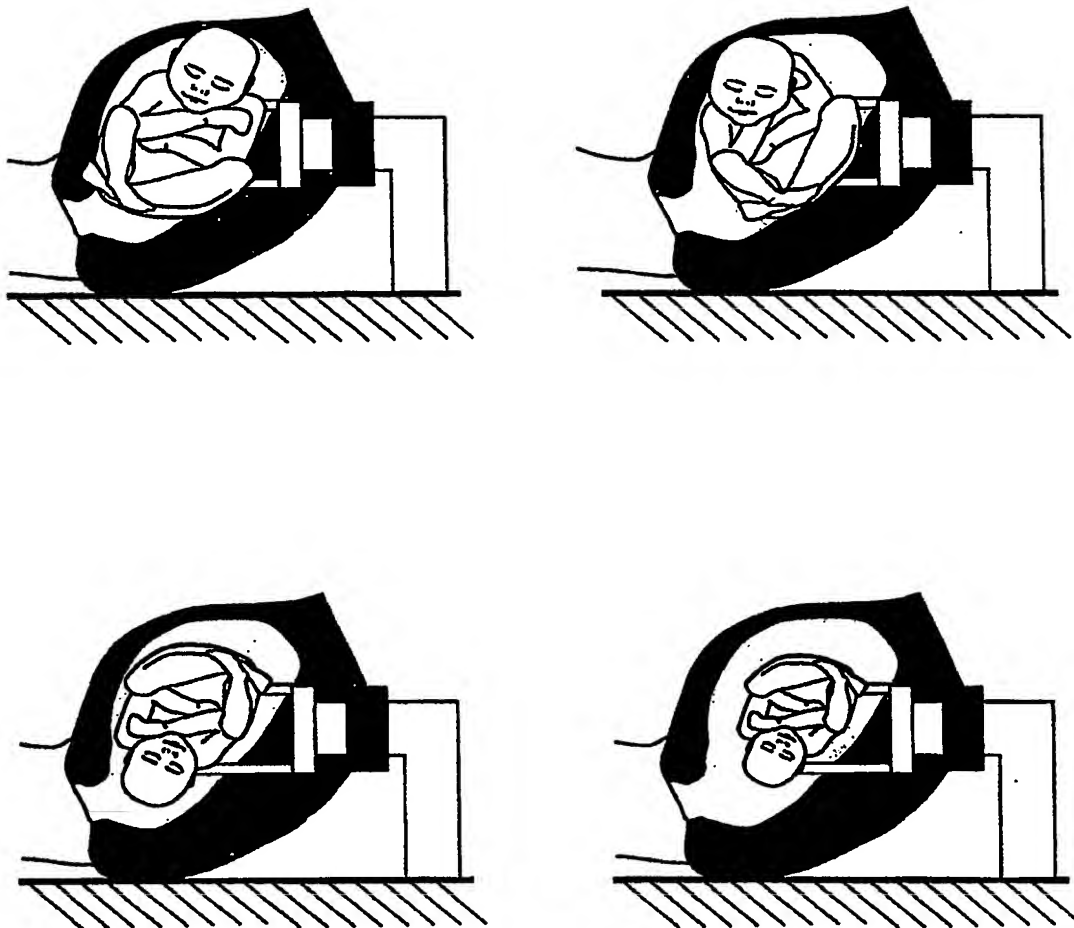


Fig. 3



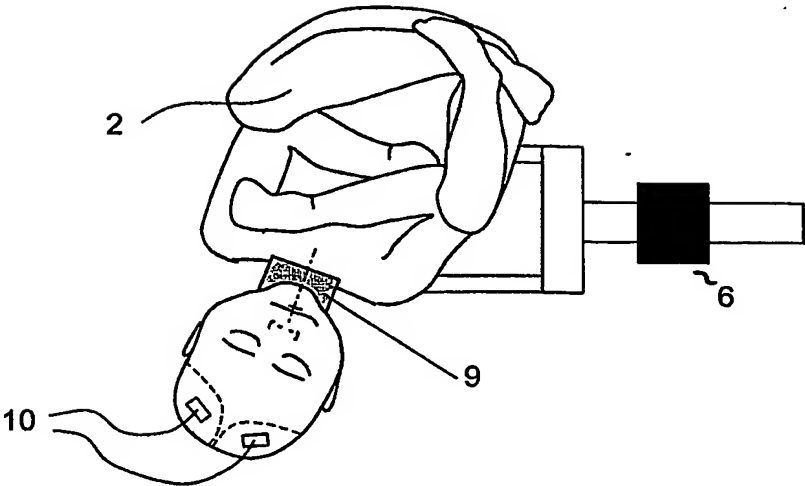


Fig. 4

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/DE2004/001332

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 G09B23/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G09B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 03/001482 A (RIENER, ROBERT; BURGKART, RAINER) 3 January 2003 (2003-01-03) the whole document	1-7
Y	WO 03/001483 A (RIENER, ROBERT; BURGKART, RAINER) 3 January 2003 (2003-01-03) page 22, line 17 - page 23, line 33 page 35, line 13 - line 15	1-7
A	US 6 503 087 B1 (EGGERT JOHN S ET AL) 7 January 2003 (2003-01-07) column 1, line 16 - column 3, line 29; figures 4,5a,10 column 4, line 35 - line 46 column 8, line 21 - column 9, line 15 ----- -/--	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 February 2005

Date of mailing of the international search report

18/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Giemsa, F

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2004/001332

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>WO 03/041034 A (DEL-SIM LTD; OHEL, GONEN;            UZIEL, YACOV; MOR, YEHOShUA)            15 May 2003 (2003-05-15)            page 4 - page 5; figures 5a,5b            -----</p>	1-7

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/001332

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 03001482	A	03-01-2003	DE 10130485 A1	16-01-2003
			DE 10202504 A1	31-07-2003
			DE 10202503 A1	31-07-2003
			DE 10202502 A1	31-07-2003
			BR 0210702 A	20-07-2004
			WO 03001483 A1	03-01-2003
			WO 03001482 A2	03-01-2003
			EP 1402503 A1	31-03-2004
			EP 1402502 A2	31-03-2004
			JP 2004530942 T	07-10-2004
			US 2004254771 A1	16-12-2004
			US 2005014115 A1	20-01-2005
WO 03001483	A	03-01-2003	DE 10130485 A1	16-01-2003
			BR 0210702 A	20-07-2004
			WO 03001483 A1	03-01-2003
			WO 03001482 A2	03-01-2003
			EP 1402503 A1	31-03-2004
			EP 1402502 A2	31-03-2004
			JP 2004530942 T	07-10-2004
			US 2004254771 A1	16-12-2004
			US 2005014115 A1	20-01-2005
US 6503087	B1	07-01-2003	US 6527558 B1	04-03-2003
			US 6443735 B1	03-09-2002
			US 6193519 B1	27-02-2001
			US 5853292 A	29-12-1998
			AU 9698901 A	15-04-2002
			EP 1342224 A1	10-09-2003
			JP 2004520606 T	08-07-2004
			WO 0229765 A1	11-04-2002
			US 2003073060 A1	17-04-2003
			US 2004214150 A1	28-10-2004
			US 2004157199 A1	12-08-2004
			US 2003091968 A1	15-05-2003
WO 03041034	A	15-05-2003	WO 03041034 A1	15-05-2003

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001332

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 G09B23/28

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G09B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 03/001482 A (RIENER, ROBERT; BURKGART, RAINER) 3. Januar 2003 (2003-01-03) das ganze Dokument	1-7
Y	WO 03/001483 A (RIENER, ROBERT; BURKGART, RAINER) 3. Januar 2003 (2003-01-03) Seite 22, Zeile 17 - Seite 23, Zeile 33 Seite 35, Zeile 13 - Zeile 15	1-7
A	US 6 503 087 B1 (EGGERT JOHN S ET AL) 7. Januar 2003 (2003-01-07) Spalte 1, Zeile 16 - Spalte 3, Zeile 29; Abbildungen 4, 5a, 10 Spalte 4, Zeile 35 - Zeile 46 Spalte 8, Zeile 21 - Spalte 9, Zeile 15 ----- -/--	1-7



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

9. Februar 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

18/02/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Giemsma, F

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2004/001332

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>WO 03/041034 A (DEL-SIM LTD; OHEL, GONEN;            UZIEL, YACOV; MOR, YEHOShUA)            15. Mai 2003 (2003-05-15)            Seite 4 - Seite 5; Abbildungen 5a,5b</p>	1-7

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001332

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 03001482 A	03-01-2003	DE 10130485 A1	16-01-2003
		DE 10202504 A1	31-07-2003
		DE 10202503 A1	31-07-2003
		DE 10202502 A1	31-07-2003
		BR 0210702 A	20-07-2004
		WO 03001483 A1	03-01-2003
		WO 03001482 A2	03-01-2003
		EP 1402503 A1	31-03-2004
		EP 1402502 A2	31-03-2004
		JP 2004530942 T	07-10-2004
		US 2004254771 A1	16-12-2004
		US 2005014115 A1	20-01-2005
WO 03001483 A	03-01-2003	DE 10130485 A1	16-01-2003
		BR 0210702 A	20-07-2004
		WO 03001483 A1	03-01-2003
		WO 03001482 A2	03-01-2003
		EP 1402503 A1	31-03-2004
		EP 1402502 A2	31-03-2004
		JP 2004530942 T	07-10-2004
		US 2004254771 A1	16-12-2004
		US 2005014115 A1	20-01-2005
US 6503087 B1	07-01-2003	US 6527558 B1	04-03-2003
		US 6443735 B1	03-09-2002
		US 6193519 B1	27-02-2001
		US 5853292 A	29-12-1998
		AU 9698901 A	15-04-2002
		EP 1342224 A1	10-09-2003
		JP 2004520606 T	08-07-2004
		WO 0229765 A1	11-04-2002
		US 2003073060 A1	17-04-2003
		US 2004214150 A1	28-10-2004
		US 2004157199 A1	12-08-2004
		US 2003091968 A1	15-05-2003
WO 03041034 A	15-05-2003	WO 03041034 A1	15-05-2003

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**